



Compras



Informativo Quality


Versão do Sistema: 3.0.12.2

Versão do Banco: 286.1

Informações sobre as melhorias no sistema para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

1. Alteração no formato de Relatório

Via solicitação de Cliente criado novo relatório de termo de referência que suprime, algumas informações, secretaria requisitante, justificativa, condições e etc, abaixo exemplo de como ficou o relatório



Exercício: 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria Requiritante: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável pela emissão do termo de referência: _____

Objeto: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS ESFS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO.

Código	Produto	Unidade	Qtd.
28.533	CAMARA ESCURA - peso líquido 750kg, peso bruto 1.060kg, dimensões 340mm (comprimento), 230mm (altura) e 230mm (largura).	Unidade	3
28.534	KIT DE POSICIONADOR - com 04 auto radiográfica periapical e interproximal tem sua composição a base de poliacetato, policarbonato, pigmento e silicossabão. Sua função é prender a película radiográfica na área de pressão, permitindo a execução das radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão.	Unidade	3
28.531	RAJO X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL - bivolt 127V e 220V, conversor manual, comando eletrônico digital microprocessado centesimal, cabeçote de raio x com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado a vácuo proporcionando uma vida mais longa ao aparelho, cabo espiralado que permite o disparo até 5 metros de distância, articulação com movimento de 360°, pintura com tinta poliuretana.	Unidade	3
28.532	ULTRASSON PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO - tipo de proteção contra choque elétrico, equipamento de classe II, frequência de 32 KHz, grau de proteção contra choque elétrico parte aplicada tipo B, consumo de ar 10l/min, grau de proteção contra penetração de líquidos IPX 0, pressão entrada de ar comprimido 60 a 80, capacidade de líquido reservatório de água 500ml, capacidade de líquido reservatório de líquido antisséptico, peso líquido 3,10kg, altura 13,5cm com reservatório bomba peristáltica, largura 21,8 cm, comprimento 24,0 cm	Unidade	5

Justificativa: COM A AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SERÁ POSSIVEL MELHORAR O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA UNIDADES DE ESFS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE _____


Condições de Garantia/Assistência Técnica: GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO.

Condições de Entrega: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO MAXIMO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

Valor Estimado: R\$ _____

Observações Gerais: As despesas com a aquisição do objeto ora licitado ocorrerão à conta da Dotação Orçamentária. ...

Dotação Orçamentária: _____



Exercício: 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Local de entrega da nota fiscal e pagamento: _____

Responsável pelo Recebimento: _____

Local: _____

Data 20/01/2020


Local: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS DHS

Identificação e assinatura do servidor

Aprova, em ____ de ____ de ____.

Identificação e assinatura da autoridade

Figura 1



Exercício: 2020

TERMO DE REFERÊNCIA

Responsável pela emissão do termo de referência: _____

Objeto: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS ESFS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELO PERIODO DE 01(UM) ANO.

Código	Produto	Unidade	Qtd.
28.533	CAMARA ESCURA - peso líquido 750kg, peso bruto 1.060kg, dimensões 340mm (comprimento), 230mm (altura) e 230mm (largura).	Unidade	3
28.534	KIT DE POSICIONADOR - com 04 auto radiográfica periapical e interproximal tem sua composição a base de poliacetato, policarbonato, pigmento e silicossabão. Sua função é prender a película radiográfica na área de pressão, permitindo a execução das radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão.	Unidade	3
28.531	RAJO X ODONTOLÓGICO COLUNA MOVEL - bivolt 127V e 220V, conversor manual, comando eletrônico digital microprocessado centesimal, cabeçote de raio x com ampola totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado a vácuo proporcionando uma vida mais longa ao aparelho, cabo espiralado que permite o disparo até 5 metros de distância, articulação com movimento de 360°, pintura com tinta poliuretana.	Unidade	3
28.532	ULTRASSON PIEZOELETRICO E JATO DE BICARBONATO - tipo de proteção contra choque elétrico, equipamento de classe II, frequência de 32 KHz, grau de proteção contra choque elétrico parte aplicada tipo B, consumo de ar 10l/min, grau de proteção contra penetração de líquidos IPX 0, pressão entrada de ar comprimido 60 a 80, capacidade de líquido reservatório de água 500ml, capacidade de líquido reservatório de líquido antisséptico, peso líquido 3,10kg, altura 13,5cm com reservatório bomba peristáltica, largura 21,8 cm, comprimento 24,0 cm	Unidade	5

Figura 2

A figura 1 ilustra como é o formato do relatório padrão, e logo a abaixo o relatório modificado.

Para obter o relatório modificado deve seguir os seguintes passos

Menu: Arquivo > Configuração do Sistema; aba relatórios, alterar o modelo de termo de referência para: modelo 2 - sem info. Solicitante, conforme figura 3


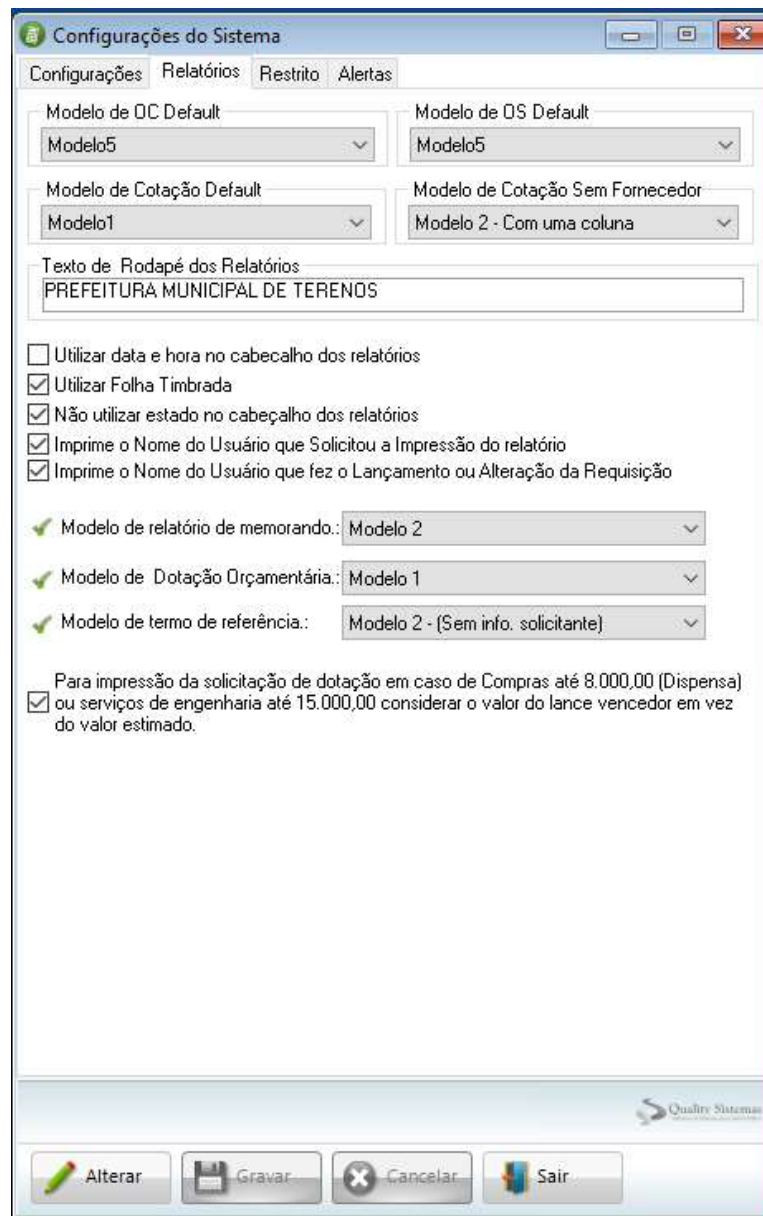


Figura 3

2. Alteração no formato de Relatório de requisições

Foi suprimida a informação do responsável do órgão, ficando no relatório de requisições apenas o responsável pela compra

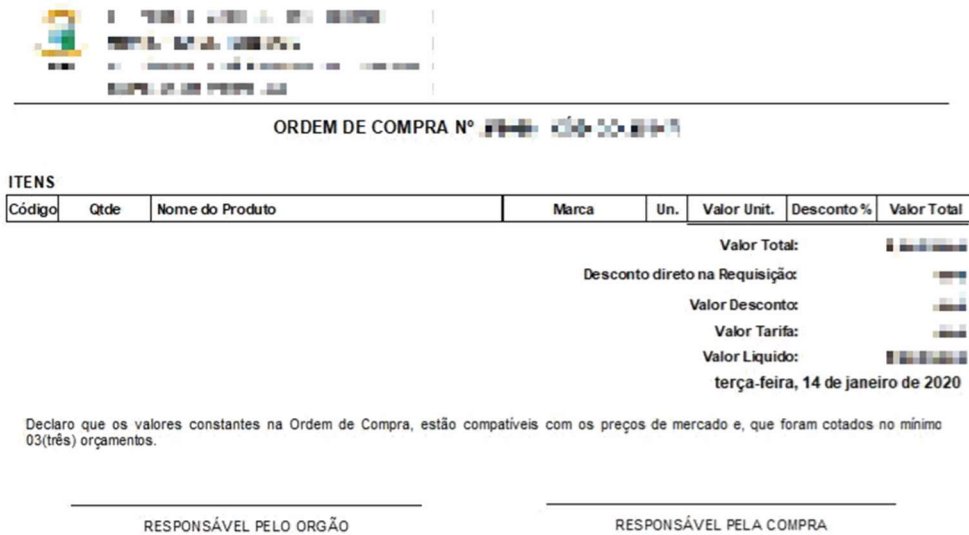

ORDEM DE COMPRA Nº [REDACTED]


Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
Valor Total: [REDACTED] Desconto direto na Requisição: [REDACTED] Valor Desconto: [REDACTED] Valor Tarifa: [REDACTED] Valor Liquido: [REDACTED]							
terça-feira, 14 de janeiro de 2020							

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Figura 4

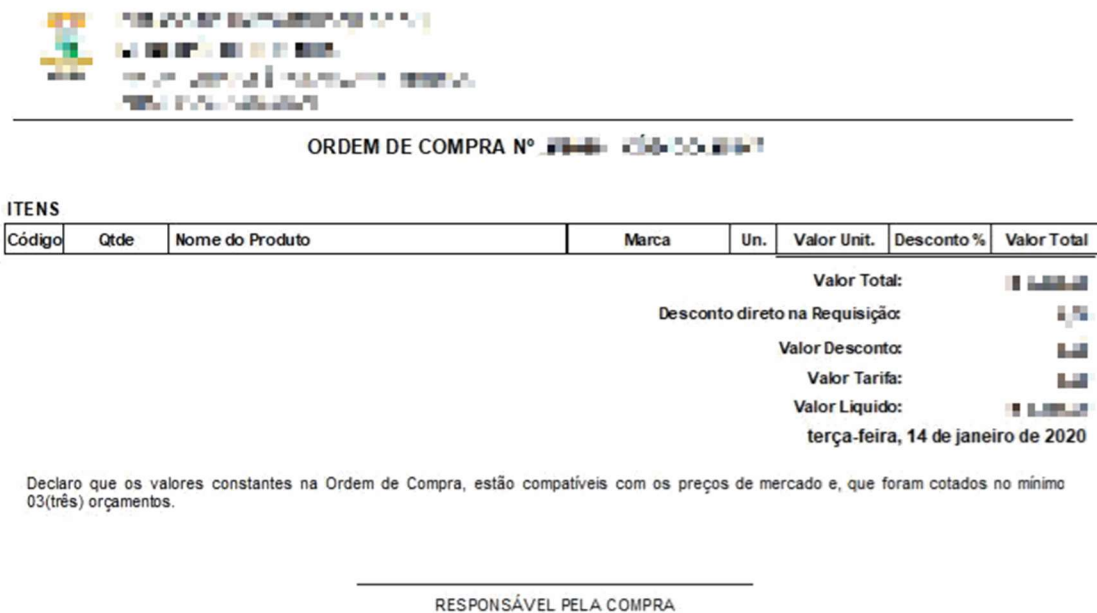

ORDEM DE COMPRA Nº [REDACTED]

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
Valor Total: [REDACTED] Desconto direto na Requisição: [REDACTED] Valor Desconto: [REDACTED] Valor Tarifa: [REDACTED] Valor Liquido: [REDACTED]							
terça-feira, 14 de janeiro de 2020							

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

Figura 5

Para obter a alteração, realize a alteração em Menu: Arquivo > Configurações do sistema > Aba Relatórios, Campo “Modelo de OC Default”, alterar para: Modelo10(=5) - (Sem Ass. Resp. Órgão)

Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato conosco.
Estamos à disposição.

Campo Grande, 20 de Janeiro 2020 .

Departamento de **Gestão de Qualidade**
Quality Sistemas